



Variolink® II

Intégration des restaurations en céramique




Restauration





Prétraitement de la céramique:
Selon les instructions du fabricant :
p.ex. IPS Empress®: 60 s.
IPS Empress® 2: 20 s.
mordancer avec gel de mordantage IPS Ceramic
(acide fluorhydrique).
Respecter les précautions d'emploi.


Monobond-S





Excite DSC





Cavité/dent





Émail Total Etch



Excite DSC



Variolink II Mix 1:1

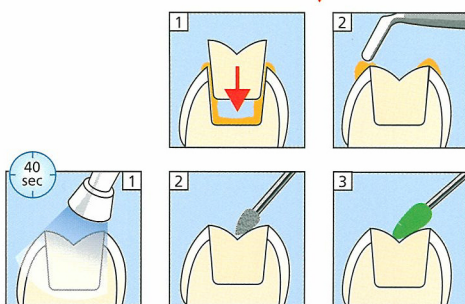

Fluoruration

